

„Euroconstant Med” SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
Cod: AGRNMD2x772;
c/f: 1018600024552

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “27” mai 2019

Licitația Nr.: 19/00011

Invitație la licitația Nr.: 19/00011 din 09.04.2019

Alternativa Nr.: _____

Către: **CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**
„Euroconstant Med” SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. Rg02-1608 din data de 02.05.2019.
- b) ÎM „Autoritate Grup” SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: dispozitive pentru blocul operator și reanimare conform necesităților IMSP, pentru anul 2019.
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **6926571,00 (șase milioane nouă sute douăzeci și șase mii cinci sute șaptezeci și unu lei 00 bani)**.
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **8311885,20 (opt milioane trei sute unsprezece mii opt sute optzeci și cinci lei 20 bani)**.
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, ÎM „Autoritate Grup” SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____

Sula


Nume: SULA Constantin

În calitate de: Director

Ofertantul: „Euroconstant Med” SRL

Adresa de reședință (poștală): mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 23/4

Data: 27.05.2019



Euroconstant Med” SRL


MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod: AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

Specificații de preț (F 4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: 19/00011	Data: „27” mai 2019	Alternativa nr.: _____
Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru aparatul diagnostic și alte investigații conform necesității IMSP, pentru anul 2019	Lot: 6-15, 17-19, 27-36, 38-39, 43-48	Pagina: 1 din 5

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Lotul 6							
	Lampa pentru examinare, 130100	Bucată	32	4000,00	4800,00	128000,00	153600,00	45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS,și instalarea/darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării
	Lotul 7							
	Lampa germicida (varianta stationara), 130110	Bucată	18	3000,00	3600,00	54000,00	64800,00	
	Lotul 8							
	Lampa germicida (varianta stationara 20m), 130120	Bucată	283	3450,00	4140,00	976350,00	1171620,00	




 Sula

Euroconstant Med" SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;

Cod:AGRNMD2x772;

c/f: 1018600024552

Lotul 9							
Lampa germicida (varianta mobilă), 130130 (caracteristici avansate)- Cod generic 1130130	Bucată	37	6000,00	7200,00	222000,00	266400,00	
Lotul 10							
Cintar electronic pentru adulti cu talionetru, 130700	Bucată	10	8700,00	10440,00	87000,00	104400,00	
Lotul 11							
Cintar electronic, pentru adulti, 130710	Bucată	8	8700,00	10440,00	69600,00	83520,00	
Lotul 12							
Cintar mecanic, pentru adulti, 130720	Bucată	6	8100,00	9720,00	48600,00	58320,00	
Lotul 13							
Cintar mecanic, cu talionetru, pentru adulti, 130730	Bucată	44	8400,00	10080,00	369600,00	443520,00	
Lotul 14							
Cintar electronic, pentru nou-născuți, 130800	Bucată	84	7700,00	9240,00	646800,00	776160,00	
Locul 15							
Cintar mecanic, pentru nou-născuți, 130810	Bucată	55	4800,00	5760,00	264000,00	316800,00	
Lotul 17							

55


Bucată

5760,00

264000,00

316800,00

Sub










M

Euroconstant Med” SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

	<i>Targa sanitara, 140360</i>	Bucată	5	2900,00	3480,00	14500,00	17400,00
	Lotul 18						
	<i>Brancarda sanitara, 140370</i>	Bucată	24	25400,00	30480,00	609600,00	731520,00
	Lotul 19						
	<i>Pat electric, pentru adulti, 140400</i>	Bucată	30	26400,00	31680,00	792000,00	950400,00
	Lotul 27						
	<i>Electroencefalograf cu functii de baza, 260100</i>	Bucată	3	150000	180000,00	450000	540000,00
	Lotul 28						
	<i>Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua, 260110</i>	Bucată	1	297000,00	356400,00	297000,00	356400,00
	Lotul 29						
	<i>Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza, 260200</i>	Bucată	21	11800,00	14160,00	247800,00	297360,00
	Lotul 30						
	<i>Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate, 260210</i>	Bucată	12	11800,00	14160,00	141600,00	169920,00
	Lotul 31						





3


Euroconstant Med” SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;


Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;

Cod:AGRRNMD2x772;

c/f: 1018600024552

Electrocardiograf 6 canale, caracteristici de baza, 260220	Bucată	2	17250,00	20700,00	34500,00	41400,00
Lotul 32						
Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate, 260221	Bucată	10	17250,00	20700,00	172500,00	207000,00
Lotul 33						
Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza, 260230	Bucată	5	24880,00	29856,00	124400,00	149280,00
Lotul 34						
Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate, 260231	Bucată	9	24880,00	29856,00	223920,00	268704,00
Lotul 35						
Monitor Holter ECG, 260260	Bucată	11	24500,00	29400,00	269500,00	323400,00
Lotul 36						
Spirograf, 260500	Bucată	6	23600,00	28320,00	141600,00	169920,00
Lotul 38						
Termometru mecanic, 260600	Bucată	2516	38,00	45,60	95608,00	114729,60
Lotul 39						
Termometru digital, 260610	Bucată	969	37,00	44,40	35853,00	43023,60



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Bula

Euroconstant Med” SRL


MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

Lotul 43									
<i>Tensiometru Adult, 260700</i>	Bucată	411	280,00	336,00	115080,00	138096,00			
Lotul 44									
<i>Tensiometru Adult cu fonoendoscop, 260710</i>	Bucată	804	265,00	318,00	213060,00	255672,00			
Lotul 45									
<i>Tensiometru Pediatric, 260720</i>	Bucată	8	250,00	300,00	2000,00	2400,00			
Lotul 46									
<i>Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop, 260730</i>	Bucată	115	290,00	348,00	33350,00	40020,00			
Lotul 47									
<i>Tensiometru semi-automat Adult, 260740</i>	Bucată	37	850,00	1020,00	31450,00	37740,00			
Lotul 48									
<i>Tensiometru semi-automat Pediatric, 260750</i>	Bucată	18	850,00	1020,00	15300,00	18360,00			
TOTAL					6926571,00	8311885,20			

Semnat: Sula Numele, Prenumele: **SULA Constantin**, În calitate de: **Director**

Ofertantul: „Euroconstant Med” SRL,

Adresa: MD-3729 r. Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru nr.45

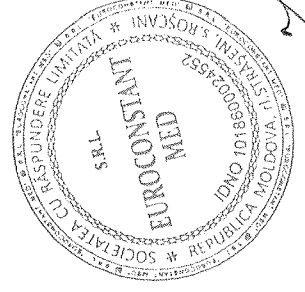

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	19/00011	Data: „27” mai 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru aparatul diagnostic și alte investigații conform necesității IMSP, pentru anul 2019	Lot: 6-15, 17-19, 27-36, 38-39, 43-48	Pagina: 1 din ___

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:							
Lotul 6							
33100000-1	Lampa pentru examinare, 130100	KS-Q3	China	Shantou Minston Medical Instruments	Lampă pentru examinare Cod 130100 Descriere Lampă de examinare cu braț articulată pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos \geq 120 mm Temperatura culorii aproximativ 4000 K	Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos 80 -250 mm Temperatura culorii 6000 – 6500 K Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala	Certificat CE ISO Declarație de conformitate



Handwritten signature: Vlad Zamb Sula


Handwritten signature: S. S.

MD-3729, r-nul Străşeni, s. Roşcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

					<p>Cu înălţime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viaţă a LED-urilor ≥ 20000 h Braţ articulată / flexibil da Nivelul de iluminare la 1 m distanţă minim 10 000 lux</p>	<p>Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viaţă a LED-urilor ≥ 20000 h Braţ articulată / flexibil da Intensitatea de iluminare 12.000 lux (la o distanţa de 30 cm)</p>	<p>Certificat CE ISO Declaraţie de conformitate</p>
<p>33100000-1</p>	<p>Lotul 7 <i>Lampa germicida (varianta staţionara), 130110</i></p>	<p>LBA – ER 30W-P</p>	<p>România</p>	<p>Biocomp SRL</p>	<p>Lampă germicidă (varianta staţionară) Cod 130110 Descriere Lampă de quart pentru sterilizarea aerului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operaţie, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz</p>	<p>Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete Da "Lampa cu tuburi, tuburile incluse în dependenţă de cantitatea solicitată cu 1 tub, 30W - 12 m² Spectru de raze UV vizibil</p>	<p>Certificat CE ISO Declaraţie de conformitate</p>


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

					Montabila pe tavan sau perete Da "Lampa cu tuburi, tuburile incluse în dependență de cantitatea solicitată" cu 1 tub, 30W, $\geq 10 \text{ m}^2$ Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore	Unghiul de iradiere 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 9000 ore	
Lotul 8							
33100000-1	<i>Lampa germicida (varianta stationara 20m), 130120</i>	LBA-ER 55W-P	România	Biocomp SRL	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Cod 130120 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aoului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete Da "Lampa cu tuburi, tuburile incluse în dependență de cantitatea solicitată" EUROCONSTANT cu 1 tub, 55W,	Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aoului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete Da "Lampa cu tuburi, tuburile incluse în dependență de cantitatea solicitată" EUROCONSTANT cu 1 tub, 55W,	Certificat CE ISO Declarație de conformitate



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

					tuburile incluse în dependența de cantitatea solicitată" cu 1 tub, 55W, ≥ 20 m ² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore	- 22 m ² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 9000 ore	
33100000-1 Lotul 9	Lampa germicida (varianta mobila), 130130 (caracteristici avansate)-Cod generic 130130	LBA-ER 2x30 W-S	România	Biocomp SRL	Lampă germicida (varianta mobilă) Cod 130130 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aoului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz Suportul dotat cu 4-6 roți Mîner pentru transportare da Da, min. 2 cu fișă da Numar de tuburi 3 tuburi, $\geq 30W$, \geq	Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aoului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz Suportul dotat cu 5 roți Mîner pentru transportare da Da, min. 2 cu fișă da Numar de tuburi 2 tuburi, - 30W, - 24 m ² Tuburile tuburile incluse în set da	Certificat CE ISO Declarație de conformitate

[Handwritten scribbles]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


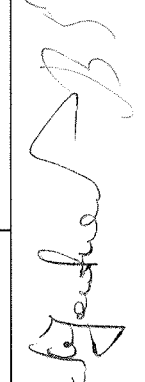

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMMD2x772;
 c/f: 1018600024552

	<p>30 m² da Tuburile tuburile incluse în set da ≥ 8000 ore da Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul de iradiere 360 grade da</p>	<p>≥ 9000 ore da Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul de iradiere 360 grade da</p>				
<p>33100000- 1</p>	<p>Lotul 10 <i>Cântar electronic pentru adulți cu taliometru, 130700</i></p>	<p>Seca 799S Cu cântar și taliometru</p>	<p>China</p>	<p>SECA GMBH & CO. KG</p>		<p>Certificat CE ISO Declarație de conformitate</p>
	<p>Cântar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateții Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ ± 50 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare da Taliometru da, 230 cm</p>	<p>Cântar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700 Descriere Cântar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateții Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ ± 50 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare da Taliometru da, 200 cm</p>				<p>54 Sula   </p>



MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

		Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ ±50 gr Calibrare manuală da				Greutatea maximă 220kg Gradația – 100 g Calibrare manuală da	
33100000-1	Lotul 13 Cântar mecanic, cu taliometru, pentru adulti, 130730	Cântar mecanic, cu taliometru, pentru adulți Cod 130730 Descriere Cântar pentru maturi destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Sensivitatea ≥ 100 gr Precizie ≤ ±10 gr Accesorii Taliometru 2000 mm Calibrare manuală da	SECA GMBH & CO. KG	China	Seca 799S + Seca 220	Cântar pentru maturi destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă - 200 kg Sensivitatea ≥ 100 gr Precizie ≤ ±10 gr Accesorii Taliometru 2000 mm Calibrare manuală da	Certificat CE ISO Declarație de conformitate
Lotul 14							



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;

Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;

Cod:AGRNMD2x772;


c/f: 1018600024552

33100000-1	<i>Cîntar electronic, pentru nou-născuți, 130800</i>	Seca 336	Germania	SECA GMBH & CO. KG	Cîntar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie $\leq \pm 5$ gr Funcția blocare greutate, (TARE) da Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se misca da Funcția Tara da Indicator de baterie descarcata da Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25 \text{mm}$ Alimentare 220V, 50Hz Autocalibrare da	Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă 20 kg Precizie $\leq \pm 5$ gr Funcția blocare greutate, (TARE) da Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se misca da Funcția Tara da Indicator de baterie descarcata da Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25 \text{mm}$ Alimentare 220V, 50Hz Autocalibrare da	Certificat CE ISO Declarație de conformitate
------------	--	----------	----------	--------------------	---	--	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

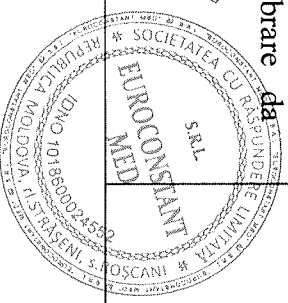

[Handwritten signature]

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

	Lotul 15						
33100000-1	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți, 130810	Seca 745	China	SECA GMBH & CO. KG	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți Cod 130810 Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă 16 kg Precizie $\leq \pm 10$ gr Calibrare manuală da	Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă 16 kg Precizie $\leq \pm 10$ gr Calibrare manuală da	Certificat CE ISO Declarație de conformitate
33100000-1	Targa sanitara, 140360	Targă sanitară foltabilă în 2	China	GIMA S.p.A. -Italia	Targa sanitară Cod 140360 Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacientilor, in cadrul departamentului de urgenta. Parametru Specificație Tip pliabila Caracteristici Fixare pacient da Tetieră reglabila da Material Bară de transport Otel	Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacientilor, in cadrul departamentului de urgenta. Parametru Specificație Tip pliabila Caracteristici Fixare pacient da Tetieră reglabila da Material Bară de transport Otel	Certificat CE ISO Declarație de conformitate

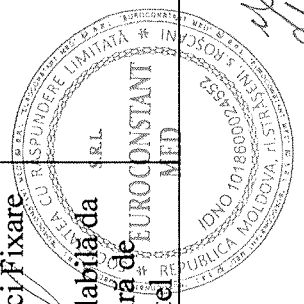

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and another signature below it.


MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMDD2x772;
 c/f: 1018600024552

					<p>Teteră reglabilă da Material Bară de transport Oțel inox/Al Acoperire stofă rezizientă lavabilă Sarcina maximă \geq 150 kg Dimensiuni in stare intinsa \leq 209 x 60 x 15 cm Dimensiuni in stare pliata \leq 98 x 60 x 20 cm Cadru de metal cu minim 3 bare transversale Să se atribuie dimensiunilor constructive</p>	<p>inox/Al Acoperire stofă rezizientă lavabilă Sarcina maximă \leq 159 kg Dimensiuni in stare intinsa 188 x 53 x 21 cm Dimensiuni in stare pliata 92 x 50 x 11 cm Cadru de metal cu minim 3 bare transversale Se atribuie dimensiunilor constructive</p>	<p>Certificat CE ISO Declarație de conformitate</p>
<p>33100000-1</p>	<p>Lotul 18 Brancarda sanitara, 140370</p>	<p>MULTIPOSITION AUTO STRETCHER</p>	<p>China</p>	<p>GIMA S.p.A. - Italia</p>	<p>Brancarda sanitara Cod 140370 Descriere Parametru Specificație Tip reglabil/fix Pozitionare Tredelinburg da Antitredelinburg da Control manual</p>	<p>Descriere Parametru Specificație Tip reglabil/fix Pozitionare Tredelinburg da Antitredelinburg da Control manual Caracteristici Bare laterale da</p>	<p>Certificat CE ISO Declarație de conformitate</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

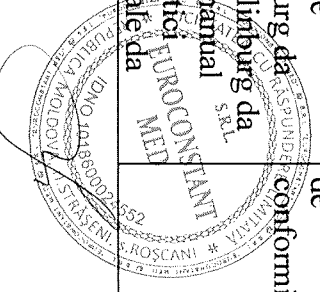

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B. C. Moldova-Agroindbank S.A. ;
 Cod:AGRNMMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>butoanele să fie însoțite de simboluri grafice</p> <p>Funcționalități poziționare, chemare asistentă</p> <p>Controlul de către asistentă</p> <p>Blocarea control pacient da</p> <p>Greutatea maximă a pacientului ≥ 220 kg</p> <p>Cu etichetă pe pat</p> <p>Înălțime Ajustabilă ≥ 84 cm</p> <p>Rotile Diametru ≥ 12.5 cm</p> <p>Sistem de blocare la minim 2 roțile</p> <p>Bare de protecție da</p> <p>Suport cap demontabil da</p> <p>Possibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în</p>	<p>Funcționalități poziționare, chemare asistentă</p> <p>Controlul de către asistentă</p> <p>Blocarea control pacient da</p> <p>Greutatea maximă a pacientului</p> <p>Cu etichetă pe pat -</p> <p>215 kg</p> <p>Înălțime Ajustabilă ≥ 84 cm</p> <p>Rotile</p> <p>Diametru ≥ 12.5 cm</p> <p>Sistem de blocare la 4 roțile</p> <p>Bare de protecție da</p>	<p>12</p>
--	--	--	--	---	--	-----------

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

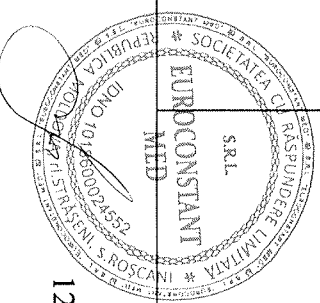

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

	fiecare colț/capt al patului da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică 220 Alimentare V, 50 Hz Saltea ortopedică în set		Neurosoft LLC	Rusia	Neiron-Spectr - 5	Lotul 27 <i>Electroencefalograf cu functii de baza, 260100</i>	33100000-1
Certificat CE ISO Declarație de conformitate	Electroencefalografu l cu funcții de bază măsură, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EEG și printează datele pentru proceduri de diagnostic. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EEG da Electroencefalografia da Altele Să se indice	Electroencefalograf cu funcții de bază Cod 260100 Descriere Electroencefalografu l cu funcții de bază măsură, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EEG și printează datele pentru proceduri de diagnostic. Parametrul Specificația					



Handwritten signatures and initials: *Sube*, *Dust*, *Sube*, *13*, *duu*

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

					<p>Aplicații Diagnosticul EEG da Electroencefalografia da Altele Să se indice Numărul de canale ≥ 32 referentiale Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 14 Gama frecvenței de lucru, Hz >200 Display Funcția freez da Afișare derivații ≥ 32 Dimensiuni ≥ 20 inci EEG în timp real da Verificarea impedenței electrodului Automată Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz Impedanța preamplificatorului, Mohm ≥ 10 Calibrarea automată da</p>	<p>Numărul de canale - 32 referentiale Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 14 Gama frecvenței de lucru, Hz >200 Display Funcția freez da Afișare derivații - 32 Dimensiuni ≥ 20 inci EEG în timp real da Verificarea impedenței electrodului Automată Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz Impedanța preamplificatorului, Mohm ≥ 10 Calibrarea automată da "Rata de calibrare selectată de utilizator" da Detectarea și interpretarea datelor da Controlul sensibilității Setări</p>
--	--	--	--	--	---	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

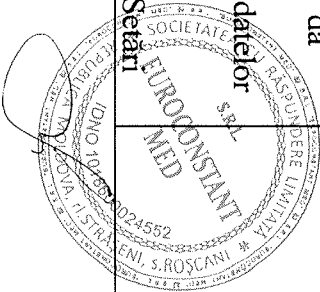

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

		<p>"Rata de calibrare selectată de utilizator" da</p> <p>Detectarea și interpretarea datelor da</p> <p>Controlul sensibilității Setări manuale da</p> <p>În pași da</p> <p>Gama, μV/mm 1-100</p> <p>Filtru de frecvență înaltă Banda, Hz ≤ 0.3 la setări de frecvență joasă</p> <p>Setare manuală da</p> <p>Filtru de frecvență înaltă Banda, Hz ≥ 70 la setări a frecvenței înalte</p> <p>Setare manuală da</p> <p>Filtru notch da</p> <p>Setare manuală da</p> <p>Video digital</p> <p>Opțiune da</p> <p>Comprimarea da</p> <p>Sincronizarea cu EEG da</p> <p>Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h</p> <p>Fotostimulator</p> <p>Optional</p> <p>Interfașă de ieșire da</p> <p>I/O auxiliare - Săse indice</p> <p>REMOTE MONITORING</p> <p>Optional</p>	<p>manuale da</p> <p>În pași da</p> <p>Gama, μV/mm 1-100</p> <p>Filtru de frecvență înaltă Banda, Hz ≤ 0.3 la setări de frecvență joasă</p> <p>Setare manuală da</p> <p>Filtru de frecvență înaltă Banda, Hz ≥ 70 la setări a frecvenței înalte</p> <p>Setare manuală da</p> <p>Filtru notch da</p> <p>Setare manuală da</p> <p>Video digital</p> <p>Opțiune da</p> <p>Comprimarea da</p> <p>Sincronizarea cu EEG da</p> <p>Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h</p> <p>Fotostimulator</p> <p>Optional</p> <p>Interfașă de ieșire da</p> <p>I/O auxiliare - Săse indice</p> <p>REMOTE MONITORING</p> <p>Optional</p>		
--	--	--	--	--	--

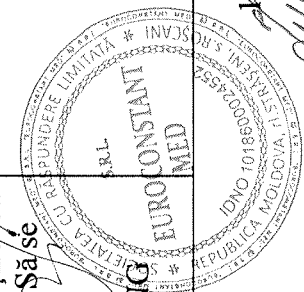

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

45
[Handwritten signature]

MD-3729, f-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552


			<p>Fotosimulator Optional</p>	<p>Intel Core 2 Duo, HDD min. 320 Gb, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență da</p>	<p>SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 320 Gb, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență da</p>	
			<p>Interfașă de ieșire da I/O auxiliare Să se indice</p>	<p>REMOTE MONITORING Optional SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 320 Gb, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență da</p>	<p>Tip de stocare HD, purători mobili (CD-R, DVD); Printer da</p>	
			<p>Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient</p>	<p>Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient</p>	<p>Afișări Afișare oră, data da Afișare ID pacient da</p>	
			<p>Afișare ID pacient da</p>	<p>Alimentare 220 V, 50 Hz da</p>	<p>Baterie internă Pentru versiunile laptop da</p>	
			<p>Baterie internă Pentru versiunile</p>			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




[Handwritten initials]

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

					laptop da		
33100000-1	Lotul 28 <i>Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua, 260110</i>	Neiron – Spectr – 5 + Neiron -Spectr – PSG + licență PSG + Licență video260	Rusia	Neurosoft LLC	Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua Cod 260110 Descriere Electroencefalografu l care măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EEG și prinează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EEG da Monitorizarea EEG da PSG da LTM da Electroencefalografia da Altele da Numărul de canale ≥ 32 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 14	Descriere Electroencefalografu l care măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EEG și prinează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EEG da Monitorizarea EEG da PSG da LTM da Electroencefalografia da Altele da Numărul de canale ≥ 32 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 14	Certificat CE ISO Declarație de conformitate

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

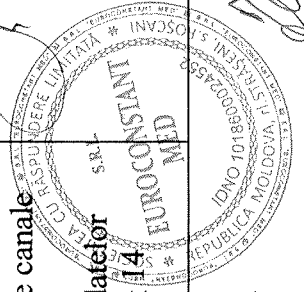





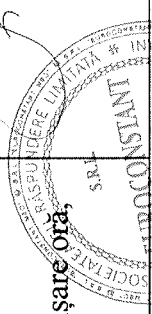

[Handwritten signature]

MD-37729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

			<p>Numărul de canale ≥ 32 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 14 Gama frecvenței de lucru, Hz > 200 Display Funcția freez da Afișare derivații ≥ 32 Dimensiuni ≥ 20 inci EEG în timp real da Verificarea impedenței electrodului Automată Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz Impedența preamplificatorului, Mohm ≥ 10 Calibrarea automată da Rata de calibrare selectată de utilizator da Detectarea și interpretarea datelor da Detectare automată da</p>	<p>Gama frecvenței de lucru, Hz > 200 Display Funcția freez da Afișare derivații ≥ 32 Dimensiuni ≥ 20 inci EEG în timp real da Verificarea impedenței electrodului Automată Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz Impedența preamplificatorului, Mohm ≥ 10 Calibrarea automată da Rata de calibrare selectată de utilizator da Detectarea și interpretarea datelor da Detectare automată da Alarme da Video digital da Comprimare da</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--	--	--	--	---	---------------------------------------

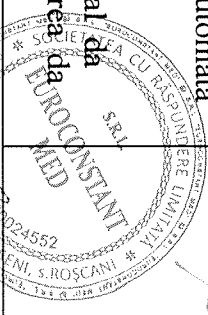

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

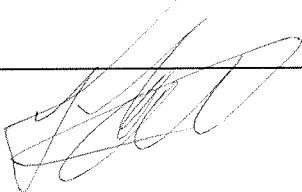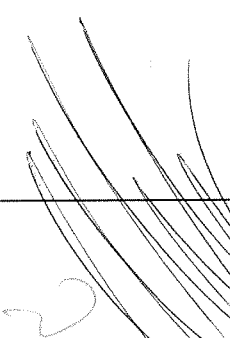
				<p>Alarme da Video digital da Comprimarea da Sincronizarea cu EEG da Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h Fotostimulator da Interfașă de ieșire da I/O auxiliare da Monitoring de la distanță Opțiune SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 320 Gb, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență da Tip de stocare HDD, purtători mobili(CD-R, DVD); Printer da Printare automată Opțiune Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient da</p>	<p>Sincronizarea cu EEG da Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h Fotostimulator da Interfașă de ieșire da I/O auxiliare da Monitoring de la distanță Opțiune SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 320 Gb, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență da Tip de stocare HDD, purtători mobili(CD-R, DVD); Printer da Printare automată Opțiune Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient da Afișări Afișare oră, data da</p>	<p>19</p>    
--	---	--	--	--	---	--


MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A. ;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				Afișări Afișare oră, data da Afișare ID pacient da Alimentare 220 V, 50 Hz da Baterie internă Pentru versiunile laptop da	Afișare ID pacient da Alimentare 220 V, 50 Hz da Baterie internă Pentru versiunile laptop da	
Lotul 29	„E3A”	China	SOMO INTERNATIONAL CO., LTD	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3	Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual	Certificat CE ISO Declarație de conformitate
33100000-1	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza, 260200					










MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz - 110 dB Convertor analog- digital - 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da</p>	<p>Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-250 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz - 110 dB Convertor analog- digital - 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da</p>
--	---	--	--	--	---

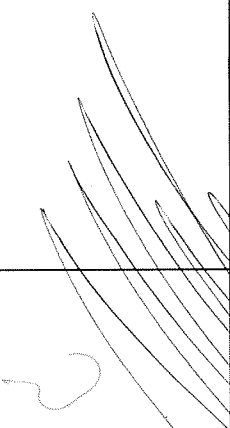

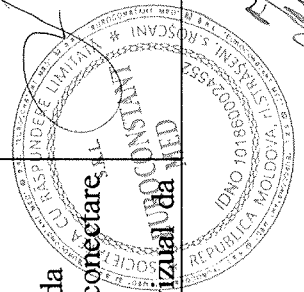Handwritten signature: *Grigore Vieru*
 Handwritten signature: *Sule*
 Handwritten number: 21
 Handwritten signature: *delia*

MD-3729, r-nul Străşeni, s. Roşcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A. ;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod Acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscrisere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da</p>	<p>Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei - 110 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscrisere 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic da LCD monochromon da "Monitorizarea pe display:</p>	<p><i>Handwritten signature</i></p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature




Handwritten signature


Handwritten signature



Handwritten signature



MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552


	<p>Display Grafic da LCD monochromon da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluție display \geq 800x480 Numărul de derivații afișate simultan - 12 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;</p>	<p>data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran - 7 inch Rezoluție display \geq 800x480 Numărul de derivații afișate simultan - 12 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;</p>					  
--	---	--	--	--	--	--	--




Sub

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator da Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set.</p>	<p>Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator da Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru</p>	
--	--	--	--	--	--	---



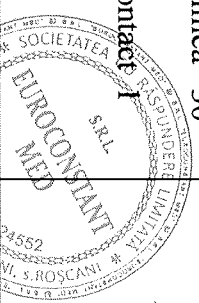Handwritten scribbles and signatures in the top left corner.

Handwritten signature: Grigore Vieru


Handwritten signature: Alex

Handwritten signature: Alex

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

					Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru		
33100000-1	Lotul 30 <i>Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate, 260210</i>	„E3A”	China	SOMO INTERNATIONAL CO., LTD	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensibilitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%	Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensibilitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%	Certificat CE ISO Declarație de conformitate

[Handwritten signature]

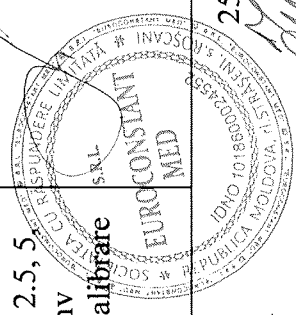

[Handwritten signature]
 25
[Handwritten signature]

MD-3729, r-nul Străşeni, s. Roşcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552


				<p>Sensibilitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 µA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da</p>	<p>Gama de frecvență De diagnostic 0.05-250 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 µA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da</p>	<p>Imprimantă Termică încorporată Mărimea hirtiei 110 mm</p>
--	--	--	--	---	--	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

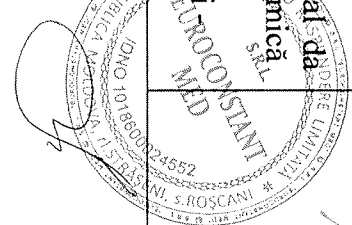

[Handwritten signature]


MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) Numărul de derivații înscrise simultan 3 Derivațiile înscrise la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da</p>	<p>Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da</p>
--	--	--	--	--	--

Handwritten signature

Handwritten signature
 27

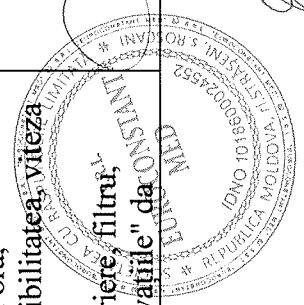


MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>data, ora, sensibilitatea, viteza de inscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran ≥ 4 inch Rezoluția ≥ 320x240 pix Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vârsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izolimei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 -</p>	<p>Marime ecran - 7 inch Rezoluția - 800x480 pix Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vârsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izolimei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da</p>	<p><i>MS</i></p>
--	--	--	--	--	---	------------------





MS

MS

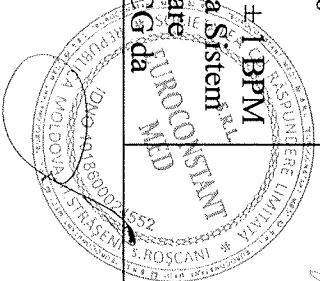MS



MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2</p>	<p>Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrție termică 30 buc. Gel de contact 1 litru</p>	<p>137</p>    
--	--	--	--	--	---	---

Stefan
 Sule
 29
 dub

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552


					set. Hîrnie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru		
33100000-1	Lotul 31 Electrocardiograf 6 canale, caracteristici de baza, 260220	„E6”	China	SOMO INTERNATIONAL CO., LTD	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza Cod 260220 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 6 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual	Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 6 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensibilitatea 2,5, 5, 10, 20 mm/mV Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%	Certificat CE ISO Declarație de conformitate

Handwritten signature


Large handwritten scribble

Handwritten signature

Handwritten signature

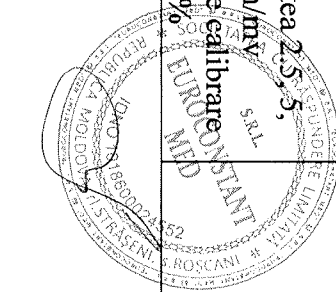

MD-3729, r-nul Străşeni, s. Roşcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 80 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT da</p>	<p>Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT da "Monitorizarea pe display:</p>	
--	--	--	--	---	---	---

Handwritten signatures and initials are present in the left margin and over the table cells.

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>"Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran ≥ 5 inch Rezoluția $\geq 640 \times 480$ pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da</p>	<p>data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran - 7 inch Rezoluția $\geq 640 \times 480$ pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da</p>	
--	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



33
[Handwritten initials]

MD-3729, r-nul Străşeni, s. Roşcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 101860024552

			<p>Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator da Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru</p>	<p>Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator da Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru</p>	<p>EUROCONSISTANT MEDICAL S.R.L. ÎNREGISTRAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA CUIA 101860024552 STR. GRIGORE VIERU 45, ROSCANI, JUDEȚA STRĂȘENI</p>
--	--	--	--	--	---

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


MD-3729, r-nul Străşeni, s. Roşcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 6 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz</p>	<p>Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 6 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare $\geq 10 M\Omega$</p>	<p><i>Handwritten signature</i></p>
--	--	--	--	---	---	-------------------------------------

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

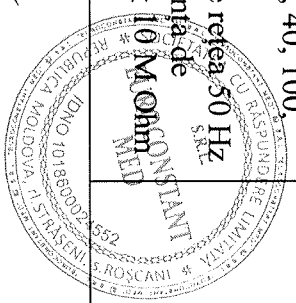

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu A$ Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 100 mm Să se indice numele derivației Viteza de înscriere printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25</p>	<p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu A$ Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 100 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$</p>	<p>37</p>
--	--	--	--	--	---	-----------




Defunctus
Sule
37

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod: AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

<p>un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da</p>	<p>ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da</p>	<p>ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operate ≥ 2,5 h autonomă</p>
--	--	--

[Handwritten signatures and scribbles]




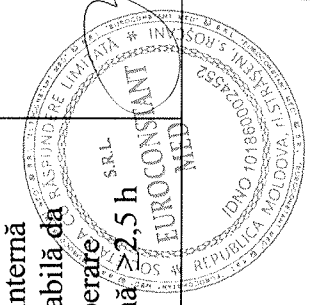


[Handwritten signature]
 39

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roscani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p> Timp operare autonomă ≥ 2.5 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hirție termică 30 buc. Gel de contact 1 litru Stand pe roțile stand pe roțile da, (indicati modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frână da mânier pentru transportarea standului da </p>	<p> Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da deconectare alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hirție termică 30 buc. Gel de contact 1 litru Stand pe roțile stand pe roțile da, (indicati modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frână da mânier pentru transportarea standului da coș pentru accesorii da </p>	<p> 40 </p>
--	--	--	--	--	--	---

5/3

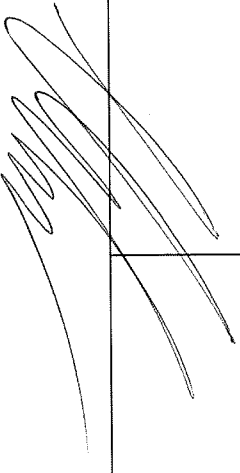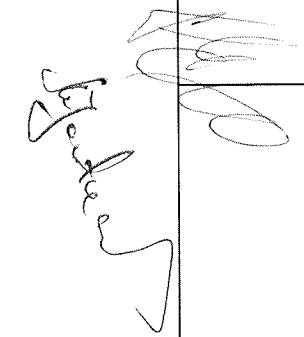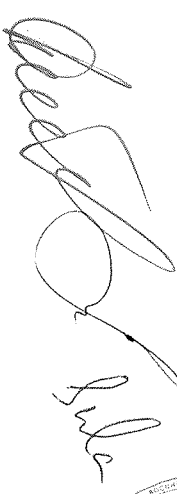40

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/E: 1018600024552

			<p>Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit</p>	<p>Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de păcămaker da</p>
--	--	--	---	---


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

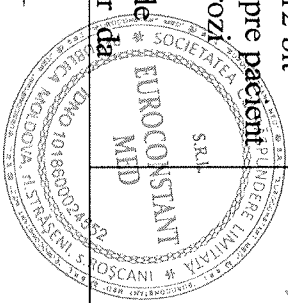

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552


	<p>Surgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu A$ Detector de pacemaker da Indicator deconectare electroz acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 110 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise</p>	<p>Indicator deconectare electroz acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei - 210 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu</p>	<p>33</p> <p>43</p> <p>13</p> <p>13</p>
--	---	---	---

de Fudera

Sule

43

13

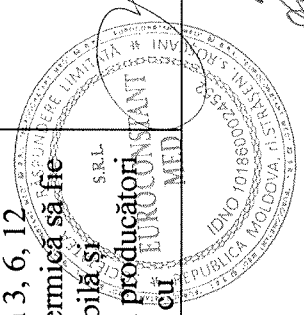

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552


				<p>simultan 3, 6, 12 Hfritia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marine ecran ≥ 7 inch Rezoluția \geq 800x480 pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card da Format date ECG "BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM" da</p>	<p>dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marine ecran - 10.4 inch Rezoluția \geq 800x480 pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card da Format date ECG "BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM" da Memorie ≥ 200 înregistrari ECG da Soft specializat pentru analiza</p>	<p>UROCONTANT S.R.L. MED</p>
--	--	--	--	--	--	--

Handwritten signature and scribbles in the top left corner.



Handwritten signature and scribbles in the middle left area.


Handwritten signature and scribbles in the bottom left area.

Handwritten signature in the bottom right area.



MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

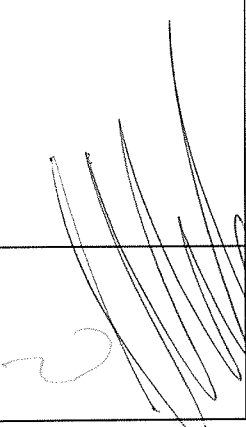				<p>Memorie ≥ 200 inregistrari ECG da Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da</p>	<p>rezultatelor ECG la calculator da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator ≥ 400 J</p>
--	---	--	--	---	---

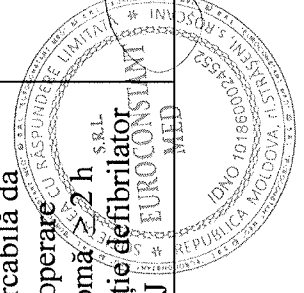


Handwritten signature: *Sule*

Handwritten text: *A5*

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552


					coș pentru accesorii da braț suport pentru electrozi ECG da suport pentru gel de contact da ajustarea pe înălțime optional sistem de fixare dispozitivului de suport da	suport pentru gel de contact da ajustarea pe înălțime optional sistem de fixare dispozitivului de suport da	
3310000- 1	Lotul 34 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate, 260231	„E12A”	China	SOMO INTERNATIONAL CO., LTD	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Cod 260231 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric	Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da	Certificat CE ISO Declarație de conformitate





 Sula

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>Numărul de canale de procesare 12</p> <p>Configurația Portabil da</p> <p>Derivațiile Tip înregistrare auto și manual</p> <p>Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv</p> <p>Semnal de calibrare 1 mV, ± 2%</p> <p>Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz</p> <p>Filtru muscular 25, 35Hz</p> <p>Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz</p> <p>Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz</p> <p>Filtru de rețea 50 Hz</p> <p>Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm</p> <p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB</p> <p>Convertor analog-digital ≥ 24 bit</p>	<p>Derivațiile Tip înregistrare auto și manual</p> <p>Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv</p> <p>Semnal de calibrare 1 mV, ± 2%</p> <p>Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz</p> <p>Filtru muscular 25, 35Hz</p> <p>Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz</p> <p>Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz</p> <p>Filtru de rețea 50 Hz</p> <p>Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm</p> <p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB</p> <p>Convertor analog-digital ≥ 24 bit</p> <p>Scurgeri spre pacient, prin electroza ≤10 µA</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Handwritten signatures and scribbles:




Top left: *SS*


Below signature: *Ștefan*

Bottom left: *Ștefan*

Handwritten signature: *Alk*

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

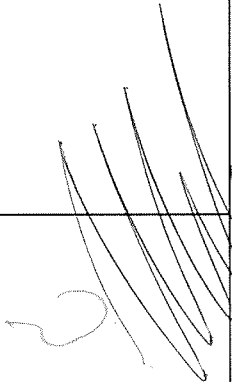				<p>Surgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu A$ Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărima hîrtiei ≥ 210 mm da Să se indice numele derivației Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise</p>	<p>Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărima hîrtiei ≥ 210 mm da Să se indice numele derivației Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise Hîrtia termică să fie compatibilă și</p>	<p>Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată Mărima hîrtiei ≥ 210 mm da Să se indice numele derivației Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise Hîrtia termică să fie compatibilă și</p>	
--	---	--	--	---	---	---	--




Handwritten signature: *Leontina*

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roscani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552


				<p>simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția \geq 800x480 pix Touchscreen da Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card da Format date ECG "BMP / JPG /</p>	<p>de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția \geq 800x480 pix Touchscreen da Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card da Format date ECG "BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM" da</p>	<p>50</p>
--	--	--	--	--	--	-----------

Handwritten signatures and initials are present in the left margin of the table, including a large signature at the top left and another at the bottom left.



MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>GIF / PDF / XML / DICOM" da Memorie ≥ 200 înregistrari ECG da Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz</p>	<p>Memorie ≥ 200 înregistrari ECG da Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da</p>	
--	--	--	--	--	---	--




51
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roscani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMMD2x772;
 c/f. 1018600024552

				<p>Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru Stand pe roțile stand pe roțile da ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da mîner pentru transportarea standului da</p>	<p>Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da status sistem da alimentare rețea da baterie descărcată da Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru Stand pe roțile stand pe roțile da ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da mîner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii da</p>	<p>52</p>
--	--	--	--	--	---	-----------

[Handwritten signatures and scribbles]




[Handwritten signature]

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

					coș pentru accesorii da braș suport pentru electrozi ECG da suport pentru gel de contact da ajustarea pe înălțime optional sistem de fixare dispozitivului de suport da	braș suport pentru electrozi ECG da suport pentru gel de contact da ajustarea pe înălțime optional sistem de fixare dispozitivului de suport da	
	Lotul 35						
33100000-1	Monitor Holter ECG, 260260	Rusia	„Monitor” LTD	„CIUJM-01 -“P-D”	Monitor Holter ECG Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da	Descriere Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat	Certificat CE ISO Declarație de conformitate

[Handwritten signatures and scribbles]



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

				<p>Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Display LCD, LED da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V DC Baterie reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 25 h Indicatori vizuali contact slab sau</p>	<p>Gama de frecvență De diagnostic 0.05-300 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Display LCD, LED da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V DC Baterie reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 25 h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem</p>	<p>54</p>
--	--	--	--	--	---	-----------


SS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]


MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

					lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Accesorii Cablul ECG 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Softul necesar pentru analiza Holter ECG pe PC da Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei da	deconectare alimentare baterie descărcată Accesorii Cablul ECG 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Softul necesar pentru analiza Holter ECG pe PC da Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei da		
Lotul 36								
33100000- 1	<i>[Signature]</i>		Rusia	„Monitor” LTD	Spirograf Cod 260500 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele	Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu,	Certificat CE ISO Declarație de conformitate	

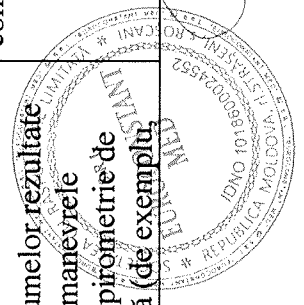

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 55

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMMD2x772;
 c/f: 1018600024552

			<p>de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Gama de volum- 0-5 l/s Gama de flux- 0-10 l/s Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie da Parametri măsurați FVC FEV1 FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV</p>	<p>capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]. Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Gama de volum- 0-5 l/s Gama de flux- 0-10 l/s Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie da Parametri măsurați FVC FEV1 FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV</p>	
--	--	--	---	---	--

53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

56

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;;
 Cod:AGRNMDD2x772;
 c/f: 1018600024552

					<p>Accesorii Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații "filtre antibacteriale sau turbine de unică utilizare" Seringă de calibrare da, (doar în cazul dacă este necesară) Clește pentru nas tip adult 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric 1 buc. Hîrtie 20 buc.</p>	<p>Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații "filtre antibacteriale sau turbine de unică utilizare" Seringă de calibrare da, (doar în cazul dacă este necesară) Clește pentru nas tip adult 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric 1 buc. Hîrtie 20 buc.</p>	
<p>33100000-1</p>	<p>Lotul 38 Termometru mecanic, 260600</p>	<p>Termometru Biosafe</p>	<p>China</p>	<p>Huaian Medicom Technology Co., LTD</p>	<p>Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade</p>	<p>Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C</p>	<p>Certificat CE ISO Declarație de conformitate</p>

55

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

58

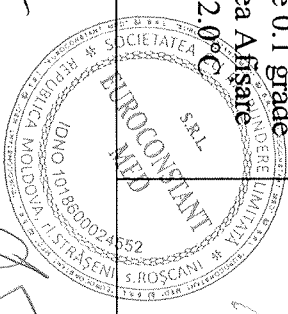

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

						Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C		
	Lotul 39							
33100000-1	<i>Termometru digital, 260610</i>	Termometru digital cu cap flexibil	China	Huaian Medicom Technology Co., LTD		Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 90 s Control on/off deconectare automată "Alarmer/ indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată pomire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da	Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 90 s Control on/off deconectare automată "Alarmer/ indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată pomire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da	Certificat CE ISO Declarație de conformitate

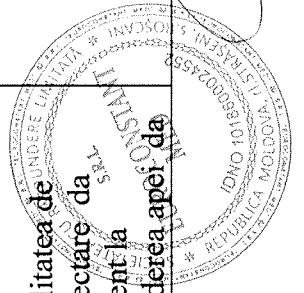

59

[Handwritten signature]


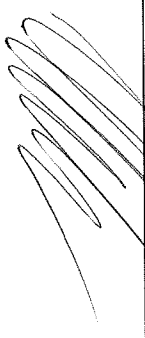
[Handwritten signature]





[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

	Lotul 43			Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrundera apei da		
33100000-1	Tensiometru Adult, 260700	YTON ANEROID SPHYGMOMANOTER - LATEX FREE	China Shanghai Caremate Medical Device Co., Ltd.	Tensiometru Adult Cod 260700 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 2 mm Hg	Certificat CE ISO Declarație de conformitate




Handwritten signature

Handwritten mark

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

	Lotul 44	Yton Aneroid Sphygmo with stethoscope	Italia	GIMA S.p.A.	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 2 mm Hg Fonoendoscop da	Certificat CE ISO Declarație de conformitate
33100000- 1	<i>Tensiometru Adult cu fonoendoscop, 260710</i>					
33100000- 1	<i>Tensiometru Adult cu fonoendoscop, 260710</i>					
Lotul 45						



Signature *Sule*


MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roscani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 101860024552

33100000-1	Tensiometru Pediatric, 260720	Tensiometru pediatric	China	Huaian Medicom Technology Co., LTD	Tensiometru Pediatric Cod 260720 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Certificat CE ISO Declarație de conformitate
	Lotul 46						
33100000-1	Tensiometru Pediatric cu fonoscop, 260730	Tensiometru pediatric cu fonoscop	China	Huaian Medicom Technology Co., LTD	Tensiometru Pediatric cu fonoscop Cod 260730	Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii	Certificat CE ISO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552


				<p>Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da</p>	<p>arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da</p>	<p>Declarație de conformitate</p>
<p>3310000- 1</p>	<p>Lotul 47 <i>Tensiometru semi- automat Adult, 260740</i></p>	<p>Yton Digital Sphygmomanometer</p>	<p>Italia</p>	<p>GIMA S.p.A.</p>	<p>Tensiometru semi- automat Adult Cod 260740 Parametrul Specificația</p>	<p>Descriere Tensiometru electronic destinat măsurării tensiunii arteriale</p> <p>Certificat CE ISO Declarație de conformitate</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

			<p>Descriere Tensiometru electronic destinat măsurării tensiunii arteriale Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice pompa din cauciuc tip extern manșetă integrală din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alimentare baterii alcaline, + 220V optional Accesorii manșetă pentru adult - 2 buc</p>	<p>Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice pompa din cauciuc tip extern manșetă integrală din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 2 mm Hg Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alimentare baterii alcaline, Accesorii manșetă pentru adult - 2 buc</p>	
	<p>Lotul 48</p>				

Handwritten mark


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature


Handwritten signature



Handwritten signature

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

33100000-1	<i>Tensiometru semi-automat Pediatric, 260750</i>	Yton Digital Sphygmomanometer	Italia	GIMA S.p.A.	Tensiometru semi-automat Pediatric Cod 260750 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic destinat măsurării tensiunii arteriale Tip portabil, pacient pediatric Caracteristici tehnice pompa din cauciuc tip extern manșetă integrală din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-280 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alimentare baterii alcaline, +	Descriere Tensiometru electronic destinat măsurării tensiunii arteriale Tip portabil, pacient pediatric Caracteristici tehnice pompa din cauciuc tip extern manșetă integrală din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-280 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alimentare baterii alcaline, Accesorii manșetă mărire pedicatrică - 2 buc	Certificat CE ISO Declarație de conformitate
------------	---	-------------------------------	--------	-------------	--	--	---

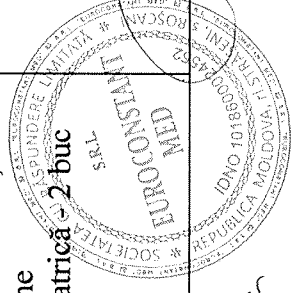


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
Tel.: (+373)79510739 ; (+373)69669333;
B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;;
Cod:AGRRNMD2x772;
c/f: 1018600024552

					220V optional Accesorii manșetă mărimē pedicatrică - 2 buc		
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnāt: Sula Numele; Prenumele: **SULA Constantin**, În calitate de: **Director**
Ofertantul: „Euroconstant Med” SRL,
Adresa: **MD-3729 r. Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru nr.45**

Stefan

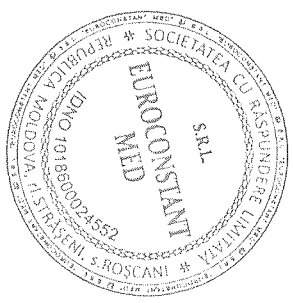

551

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]