

Specificații de preț

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție : NFP 05/DM din 06.05.2022
	Obiectul de achiziție: Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasulară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022 (repetat)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasifi cație bugeta ră (IBAN)	Disco unt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
331000 00-1	Lotul 42 Set steril getabil pentru angiografie	buc	650	625,00	750,00	406 250,00	487 500,00			
331000 00-1	Lotul 43 Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial	buc	650	541,67	650,00	352 083,33	422 500,00			
331000 00-1	Lotul 44 Câmp steril super absorbant	buc	100	15,00	18,00	1 500,00	1 800,00			
331000 00-1	Lotul 46 Capot (halat) chirurgical steril	buc	50	25,00	30,00	1 250,00	1 500,00			
						761 083,33	913 300,00			

DDP-Franco destinație vândut.Incotermis 2020, în decurs de 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.

Semnăt: _____
Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Numele, Prenumele: Boris Granaci In calitate de: Director General
Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71 Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

Numărul procedurii de achiziție : NFP 05/DM din 06.05.2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022 (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 42 Set sterili getabil pentru angiografie	SP-05006-34	Turcia	BAYTEKS TEKKNYK TEKSTYK SAN. VE TYC. A.S.	1 buc.: câmp adeziv 50x50cm. Triplu stratificat: strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm. Extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: câmp de masă instrumental 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: Câmp angiografic pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: Câmp ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție (nu mai puțin de 6,5 g/100 cm2). 4 orificii cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, dim. 70 cm. Bordurile adezive ale	1 buc.: câmp adeziv 50x50cm. Triplu stratificat: strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm. Extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: câmp de masă instrumental 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: câmp angiografic pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: Câmp ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție (nu mai puțin de 6,5 g/100 cm2). 4 orificii cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, dim. 70 cm. Bordurile adezive ale	CE/ISO




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

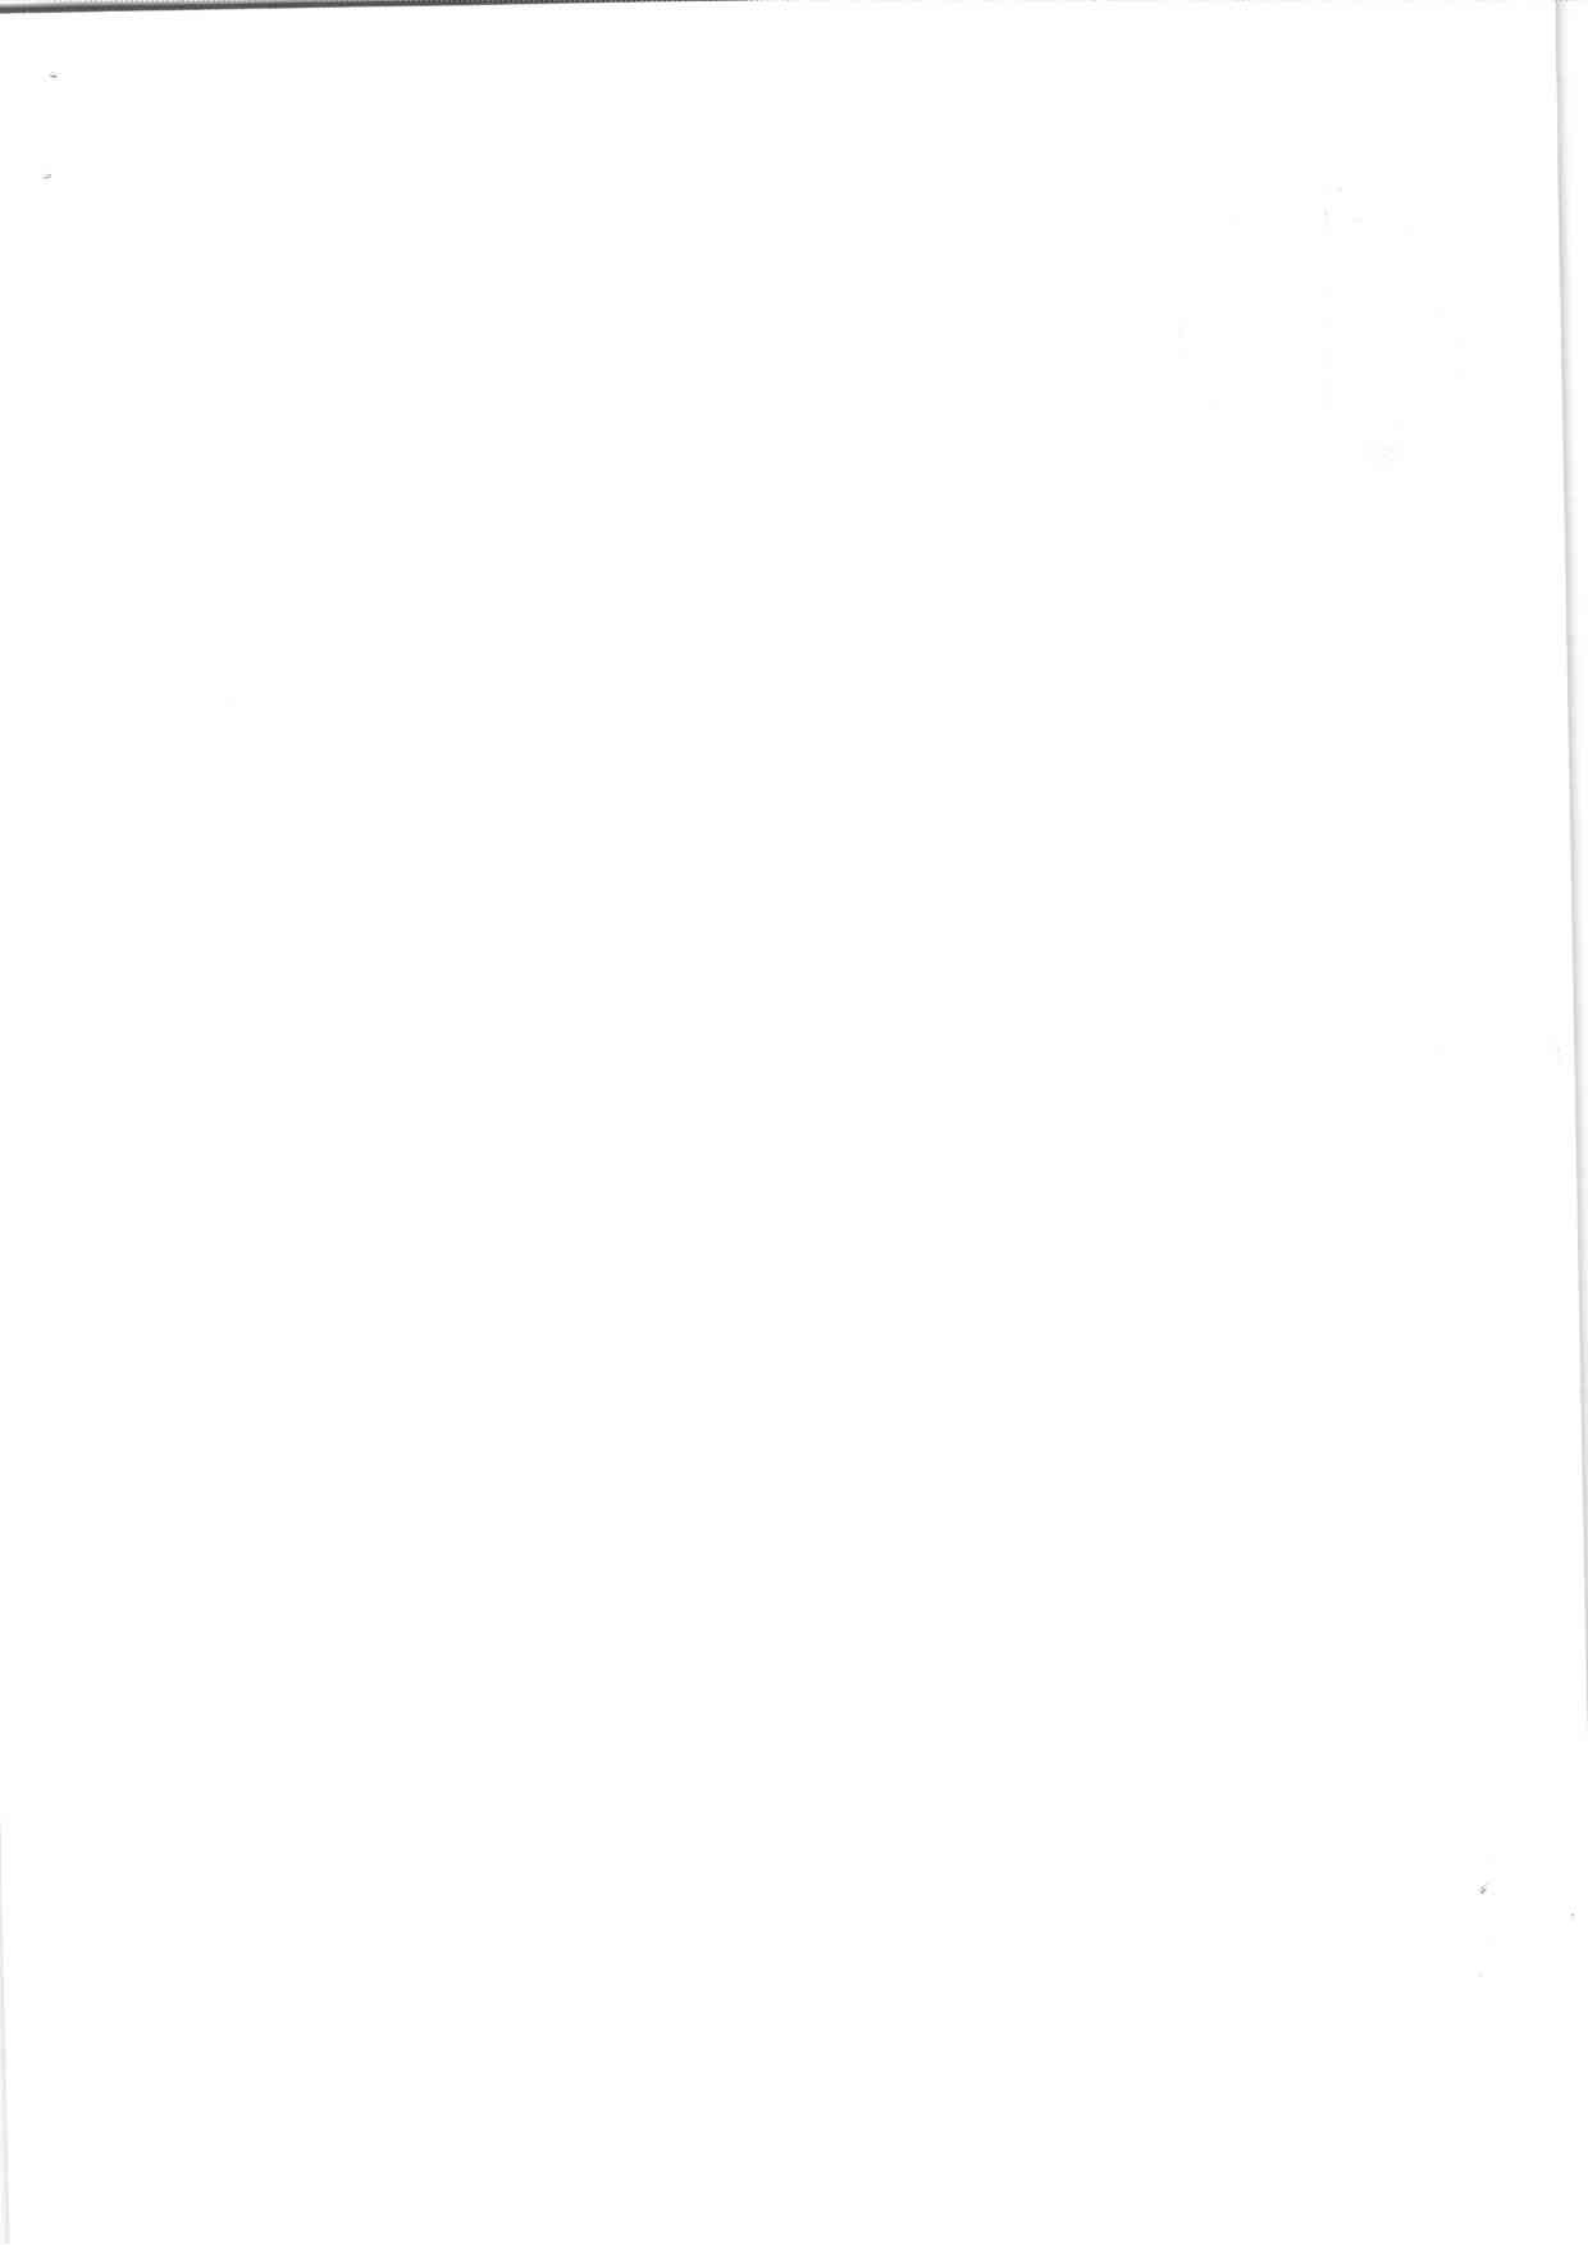

			<p>câmpului impregnate în țesătură (să nu fie lipici cu 2 fețe) pentru a nu forma cute și a asigura 100% impermeabilitate. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: cearșaf 100x150cm. Dublu stratificat. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă. 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză. 2 buc.: Halat chirurgical XL, din fibre de polipropilen, nu mai puțin de 5 tipuri de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manșete de poliester, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusută cu acul. Lungimea manecilor - nu mai puțin de 65 cm (±2 cm), lungimea halatului minim 140 cm din umeri până la poale, latimea halatului minim 75 cm în zona axilară. 2 perechi: mănuși sterile, nepudrate marimea 7.5 și 8, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistente la rupe. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent. 1 buc.: Bol 125 ml cu filet și capac. 1 buc.: Bol renal. 1 buc.: Pinceta. 1 buc.: Forceps. 1 buc.: Tăviță 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare”. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 1 buc.: Ramplă 3 căi OFF, robineti cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretanic minim 1800 mm; - sistemul de perfuzie din poliuretanic minim 1800 mm; - tub din poliuretanic, minim 1500 mm, 1,5x2,7 mm. 1 buc.: Bisturiu E11. 1 buc.: Ghid angiografic minim 175 cm, J3, 0,034-0,036”. 10 buc.: Meșe absorbante 10x10 cm minim 8 straturi. 1 buc.: Ac seringă 18G. 1 buc.: Ac seringă 21G. 1 buc.: Ac seringă 22G, 0,7x30 mm. 1 buc.: Seringă 20 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 10 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 5 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 2 ml 3 componente. 1 buc.: Bol pentru tubulatură.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emise de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie</p>
			<p>stratificată, cu grad înalt de absorbție (nu mai puțin de 6,5 g/100 cm²). 4 orificii cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, dim. 70 cm. Bordurile adezive ale câmpului impregnate în țesătură (să nu fie lipici cu 2 fețe) pentru a nu forma cute și a asigura 100% impermeabilitate. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: cearșaf 100x150cm. Dublu stratificat. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă. 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză. 2 buc.: Halat chirurgical XL, din fibre de polipropilen, nu mai puțin de 5 tipuri de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manșete de poliester, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusută cu acul. Lungimea manecilor - nu mai puțin de 65 cm (±2 cm), lungimea halatului minim 140 cm din umeri până la poale, latimea halatului minim 75 cm în zona axilară. 2 perechi: mănuși sterile, nepudrate marimea 7.5 și 8, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistente la rupe. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent. 1 buc.: Bol 125 ml cu filet și capac. 1 buc.: Bol renal. 1 buc.: Pinceta. 1 buc.: Forceps. 1 buc.: Tăviță 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare”. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 1 buc.: Ramplă 3 căi OFF, robineti cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretanic minim 1800 mm; - sistemul de perfuzie din poliuretanic minim 1800 mm; - tub din poliuretanic, minim 1500 mm, 1,5x2,7 mm. 1 buc.: Bisturiu E11. 1 buc.: Ghid angiografic minim 175 cm, J3, 0,034-0,036”. 10 buc.: Meșe absorbante</p>



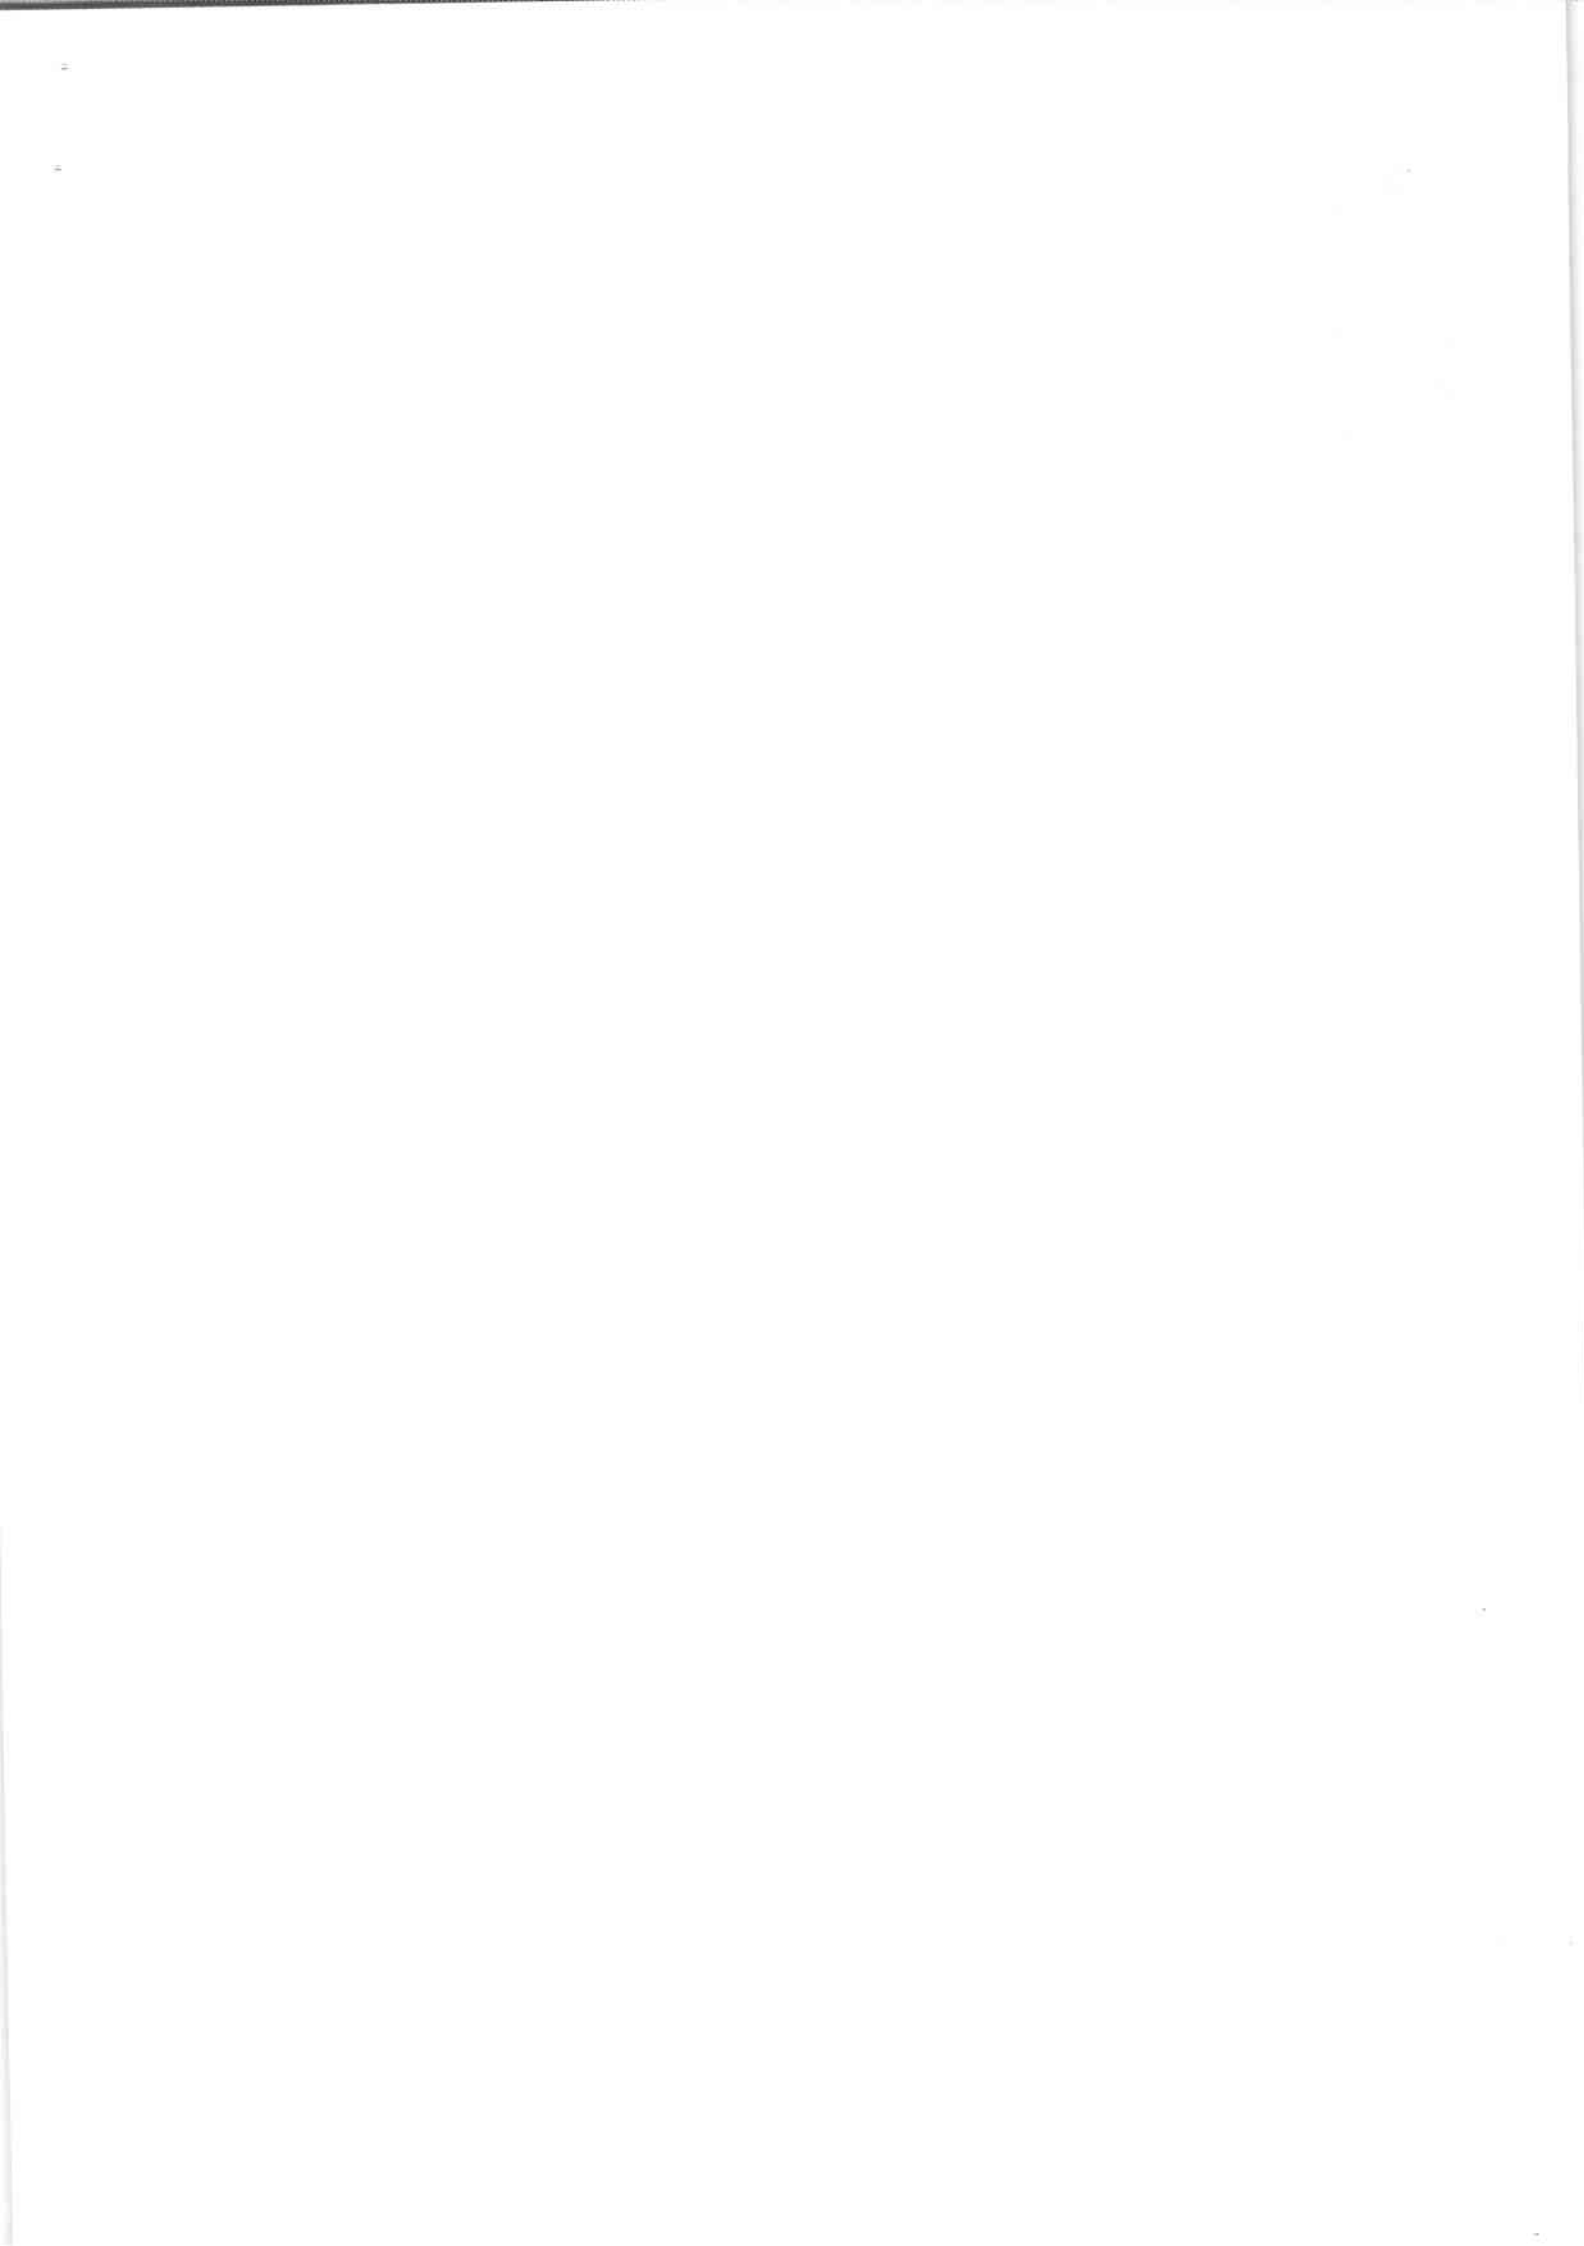


			<p>confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificările : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite –valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>10x10 cm minim 8 straturi. 1 buc.: Ac seringă 18G. 1 buc.: Ac seringă 21G. 1buc.: Ac seringă 22G, 0,7x30 mm. 1 buc.: Seringă 20 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 10 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 5 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 2 ml 3 componente. 1 buc.: Bol pentru tubulatură.</p>		
<p>Lotul 43 Set sterili getabil pentru angiografie prin abord radial</p>	<p>SP-05006-43</p>	<p>Turcia</p>	<p>BAYTEKS TEKNYK TEKSTYŁ SAN. VE TÝC. A.Ş.</p>	<p>1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu - minim 500 ml capacitate absorbție; 1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale si 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toata suprafața, ce nu permite contactul direct cu pielea. Margini laterale transparente, min. 70 cm. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă; 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic; 2 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză; 2 buc.: Halat chirurgical XL 2 perechi, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusută cu acul.; Bol renal -1 buc.; Pinceta-1 buc.; Tăviță 2500 ml din polipropilen, cu "aripioare" pentru evitarea alunecării materialelor depozitate în bol, color; 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator; 1 buc.: Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc pentru o mai buna ermetizare si manevrare rapida si usoara</p> <p>- deschidere-inchidere, rezistență la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretán minim 1800 mm, - tub din poliuretán, minim 1800 mm ; 1 buc.: Bisturiu; 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3, 0,035"-; 10 bucati; Comprese</p>	<p>1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu - minim 500 ml capacitate absorbție; 1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale si 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toata suprafața, ce nu permite contactul direct cu pielea. Margini laterale transparente, min. 70 cm. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă; 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic; 2 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză; 2 buc.: Halat chirurgical XL 2 perechi, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusută cu acul.; Bol renal -1 buc.; Pinceta-1 buc.; Tăviță 2500 ml din polipropilen, cu "aripioare" pentru evitarea alunecării materialelor depozitate în bol, color; 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator; 1 buc.: Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc pentru o mai buna ermetizare si manevrare rapida si usoara</p> <p>- deschidere-inchidere, rezistență la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretán minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretán minim 1800</p>	<p>CE/ISO</p>



Страница 3 | 6

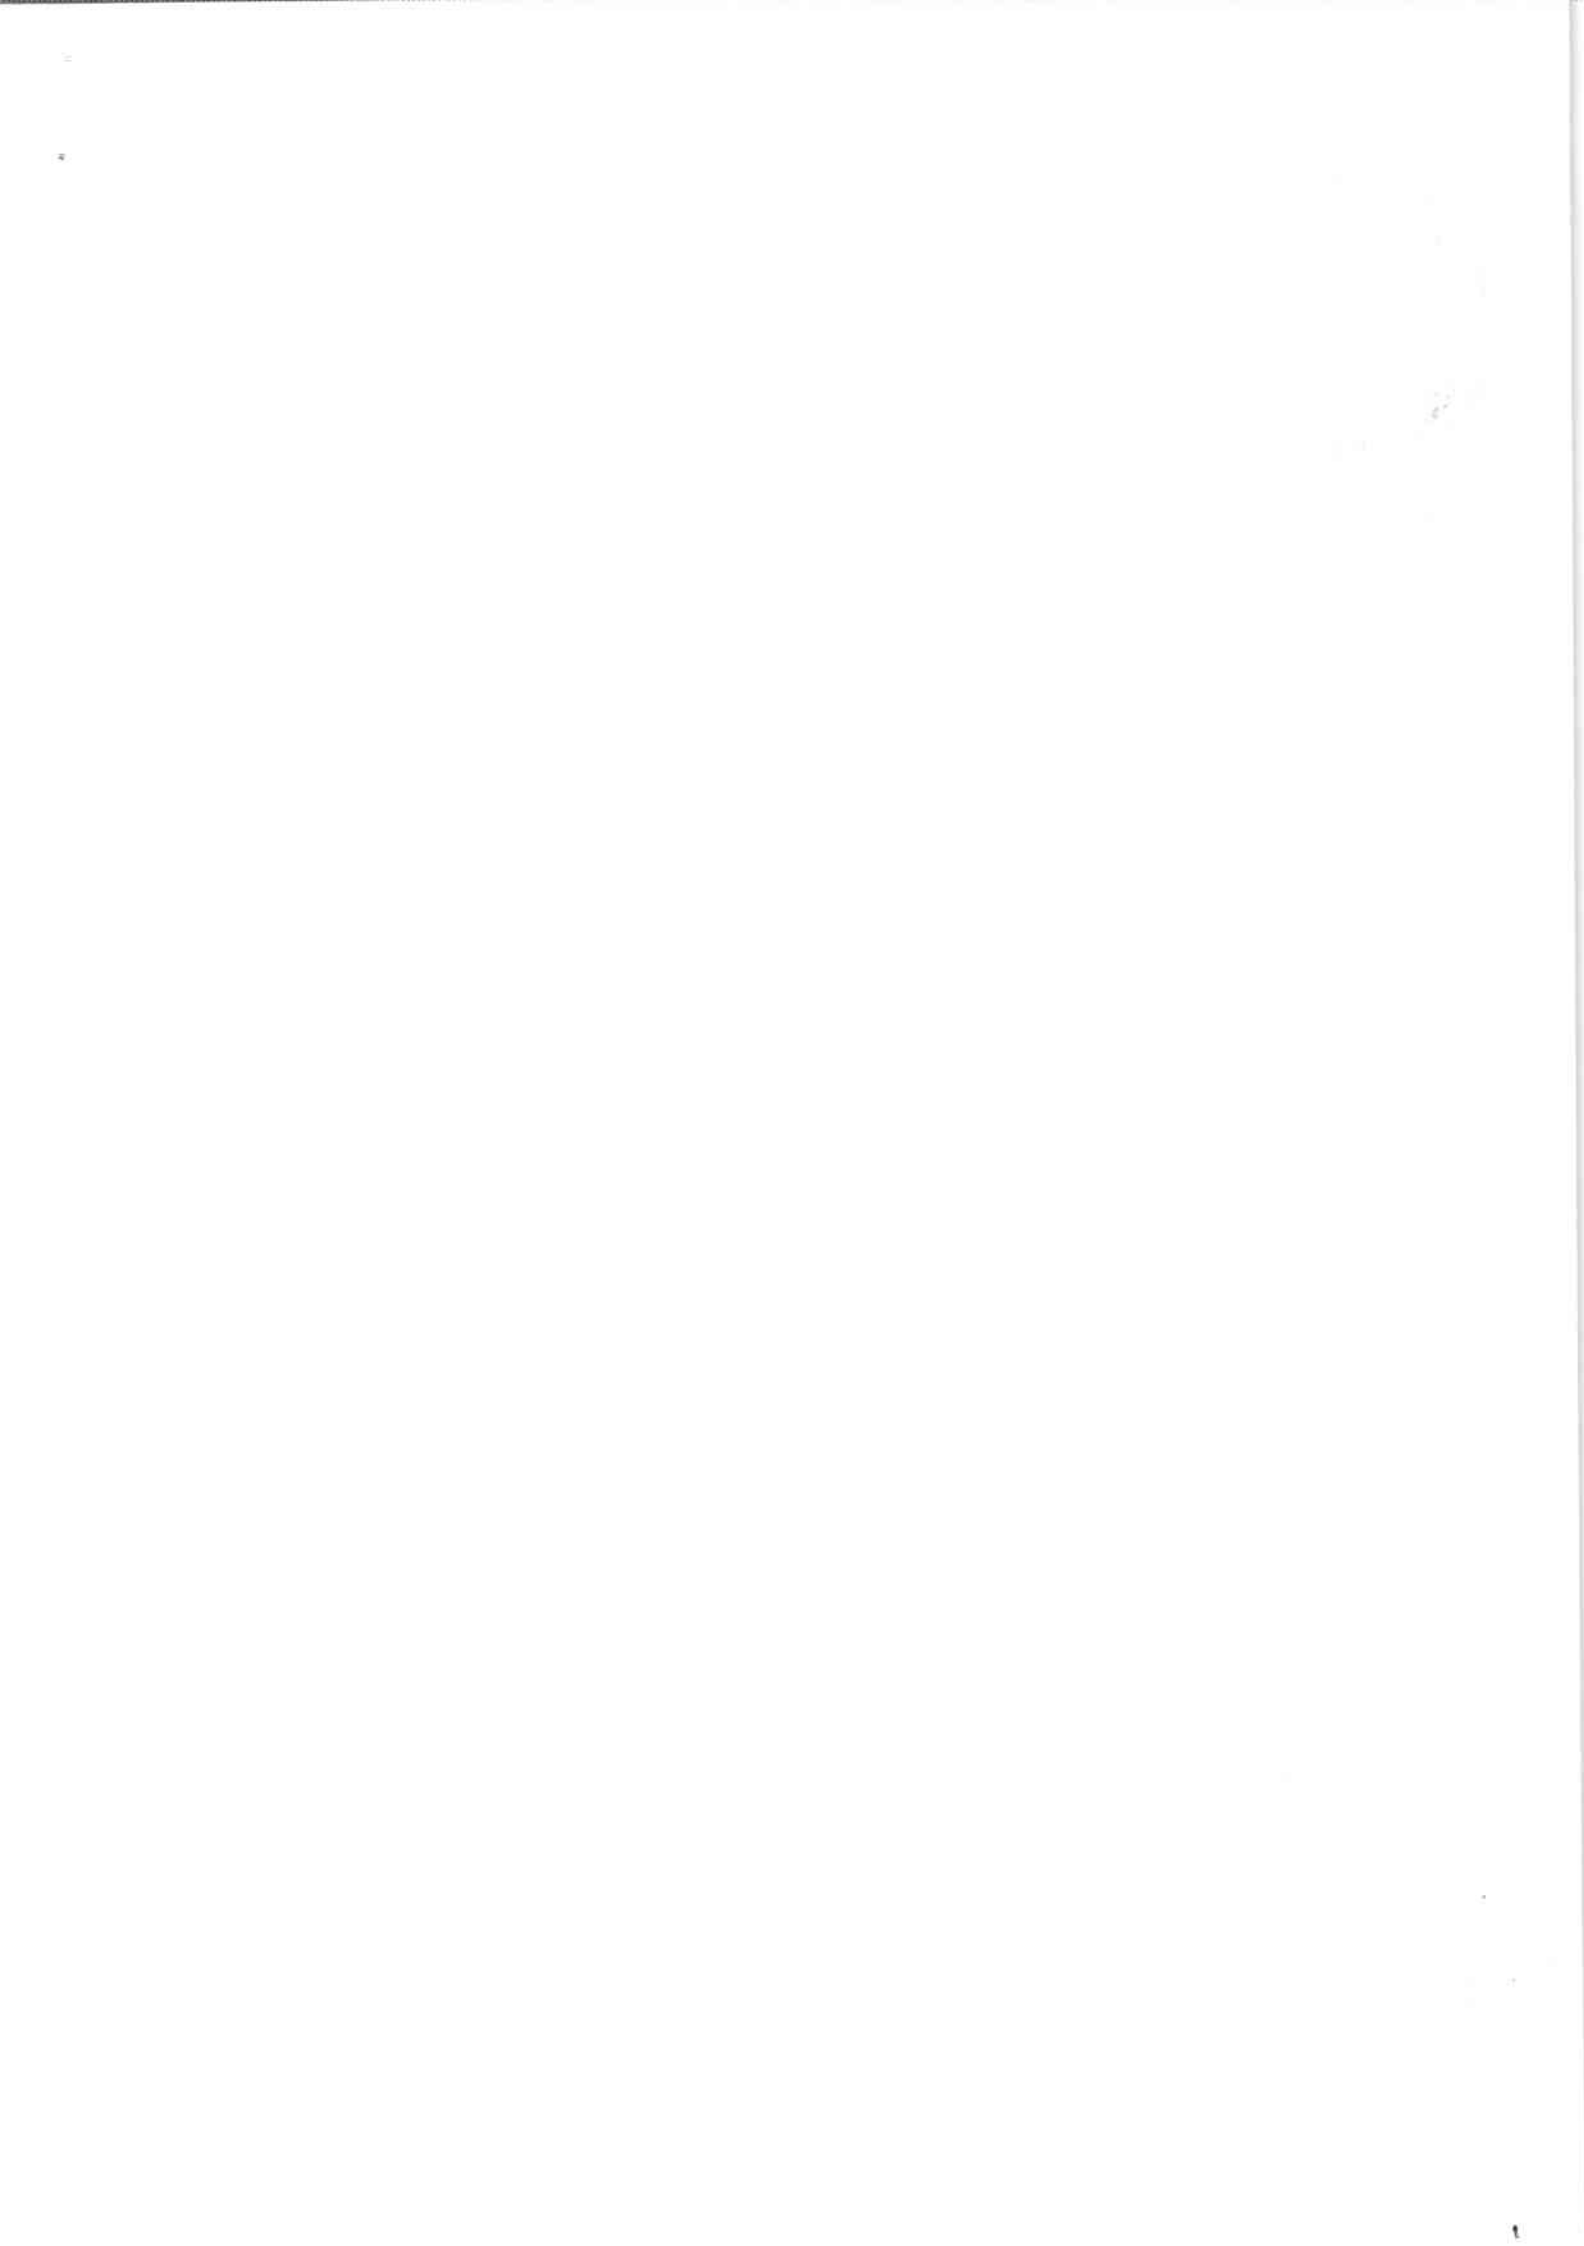

			<p>absorbant 10x10 cm 12 straturi; 1 buc.: Seringă 20 ml cu luer lock; 1 buc.:Seringă 10 ml cu luer lock; 1buc: seringa de 5 ml cu luer lock ; 1 buc.: dispencer: 1 buc container din plastic transparent cu capac. Volumul total min. 120 ml max. 200 ml, cu gradăția minim de 100 ml; gradat în ml, pasul gradăției până la 20 ml..</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participativului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate; – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>1800 mm. - tub din poliuretan, minim 1800 mm ; 1 buc.: Bisturiu; 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3, 0,035"; 10 bucati Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi; 1 buc.: Seringă 20 ml cu luer lock; 1 buc.:Seringă 10 ml cu luer lock; 1buc: seringa de 5 ml cu luer lock ; 1 buc.: dispencer: 1 buc container din plastic transparent cu capac. Volumul total min. 120 ml max. 200 ml, cu gradăția minim de 100 ml; gradat în ml, pasul gradăției până la 20 ml..</p>	
<p>Lotul 44 Câmp steril super absorbant</p>	<p>SP-05006-23</p>	<p>Turcia</p> <p>BAYTEKS TEKNÝK TEKSTÝL SAN. VE TÝC. A.Ş.</p>	<p>Dimensiuni 55x70 cm (± 5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: strat impermeabil pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni; strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm², grosimea stratului – minim 75 g/m²; strat adeziv aplicat pe margine, liber de colofoniu, se exclude lipici cu față dublă pentru a nu forma canale de aer; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sanguine).</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat</p>	<p>Dimensiuni 55x70 cm (± 5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: strat impermeabil pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni; strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm², grosimea stratului – minim 75 g/m²; strat adeziv aplicat pe margine, liber de colofoniu, se exclude lipici cu față dublă pentru a nu forma canale de aer; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor</p>	<p>CE/ISO</p>




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



			<p>al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>în vasele sangvine).</p>
<p>Lotul 46 Capot (halat) chirurgical steril</p>	<p>SG-01201- 04/SG- 01201-05</p>	<p>Turcia</p> <p>BAYTEKS TEKNYK TEKSTYL SAN. VE TYC. A.Ş.</p>	<p>Din material netesut - fibre de poliuretan, minim 3 tipuri de fibre – SMS; repelent, grosimea materialului SMS - minim 35 g/m2; mâneca cusută cu laser – cusătură dublă – pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude maneca cusută cu acul; lungimea manecilor - nu mai puțin de 60 cm (±3 cm), lungimea halatului minim 140 cm din umeri până la poale, latimea halatului în zona axilară - minim 75 cm (±3 cm); ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloză – se vor exclude modele neabsorbante; eticheta autocolanță a ambalajului va conține informație despre nr. Lotului și data expirării; indicare pe ambalaj a sterilizării cu EO (se va exclude sterilizarea cu raze Roentgen); termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani; marcaj CE; certificat ENI 3795; mostre la solicitare. Maritime XL, XXL.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis</p>	<p>Din material netesut - fibre de poliuretan, minim 3 tipuri de fibre – SMS; repelent, grosimea materialului SMS - minim 35 g/m2; mâneca cusută cu laser – cusătură dublă – pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude maneca cusută cu acul; lungimea manecilor - nu mai puțin de 60 cm (±3 cm), lungimea halatului minim 140 cm din umeri până la poale, latimea halatului în zona axilară - minim 75 cm (±3 cm); ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloză – se vor exclude modele neabsorbante; eticheta autocolanță a ambalajului va conține informație despre nr. Lotului și data expirării; indicare pe ambalaj a sterilizării cu EO (se va exclude sterilizarea cu raze Roentgen); termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani; marcaj CE; certificat ENI 3795; mostre la solicitare. Maritime XL, XXL.</p> <p>CE/ISO</p>



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

СТРАЖИНА 5/16

[Handwritten signature]

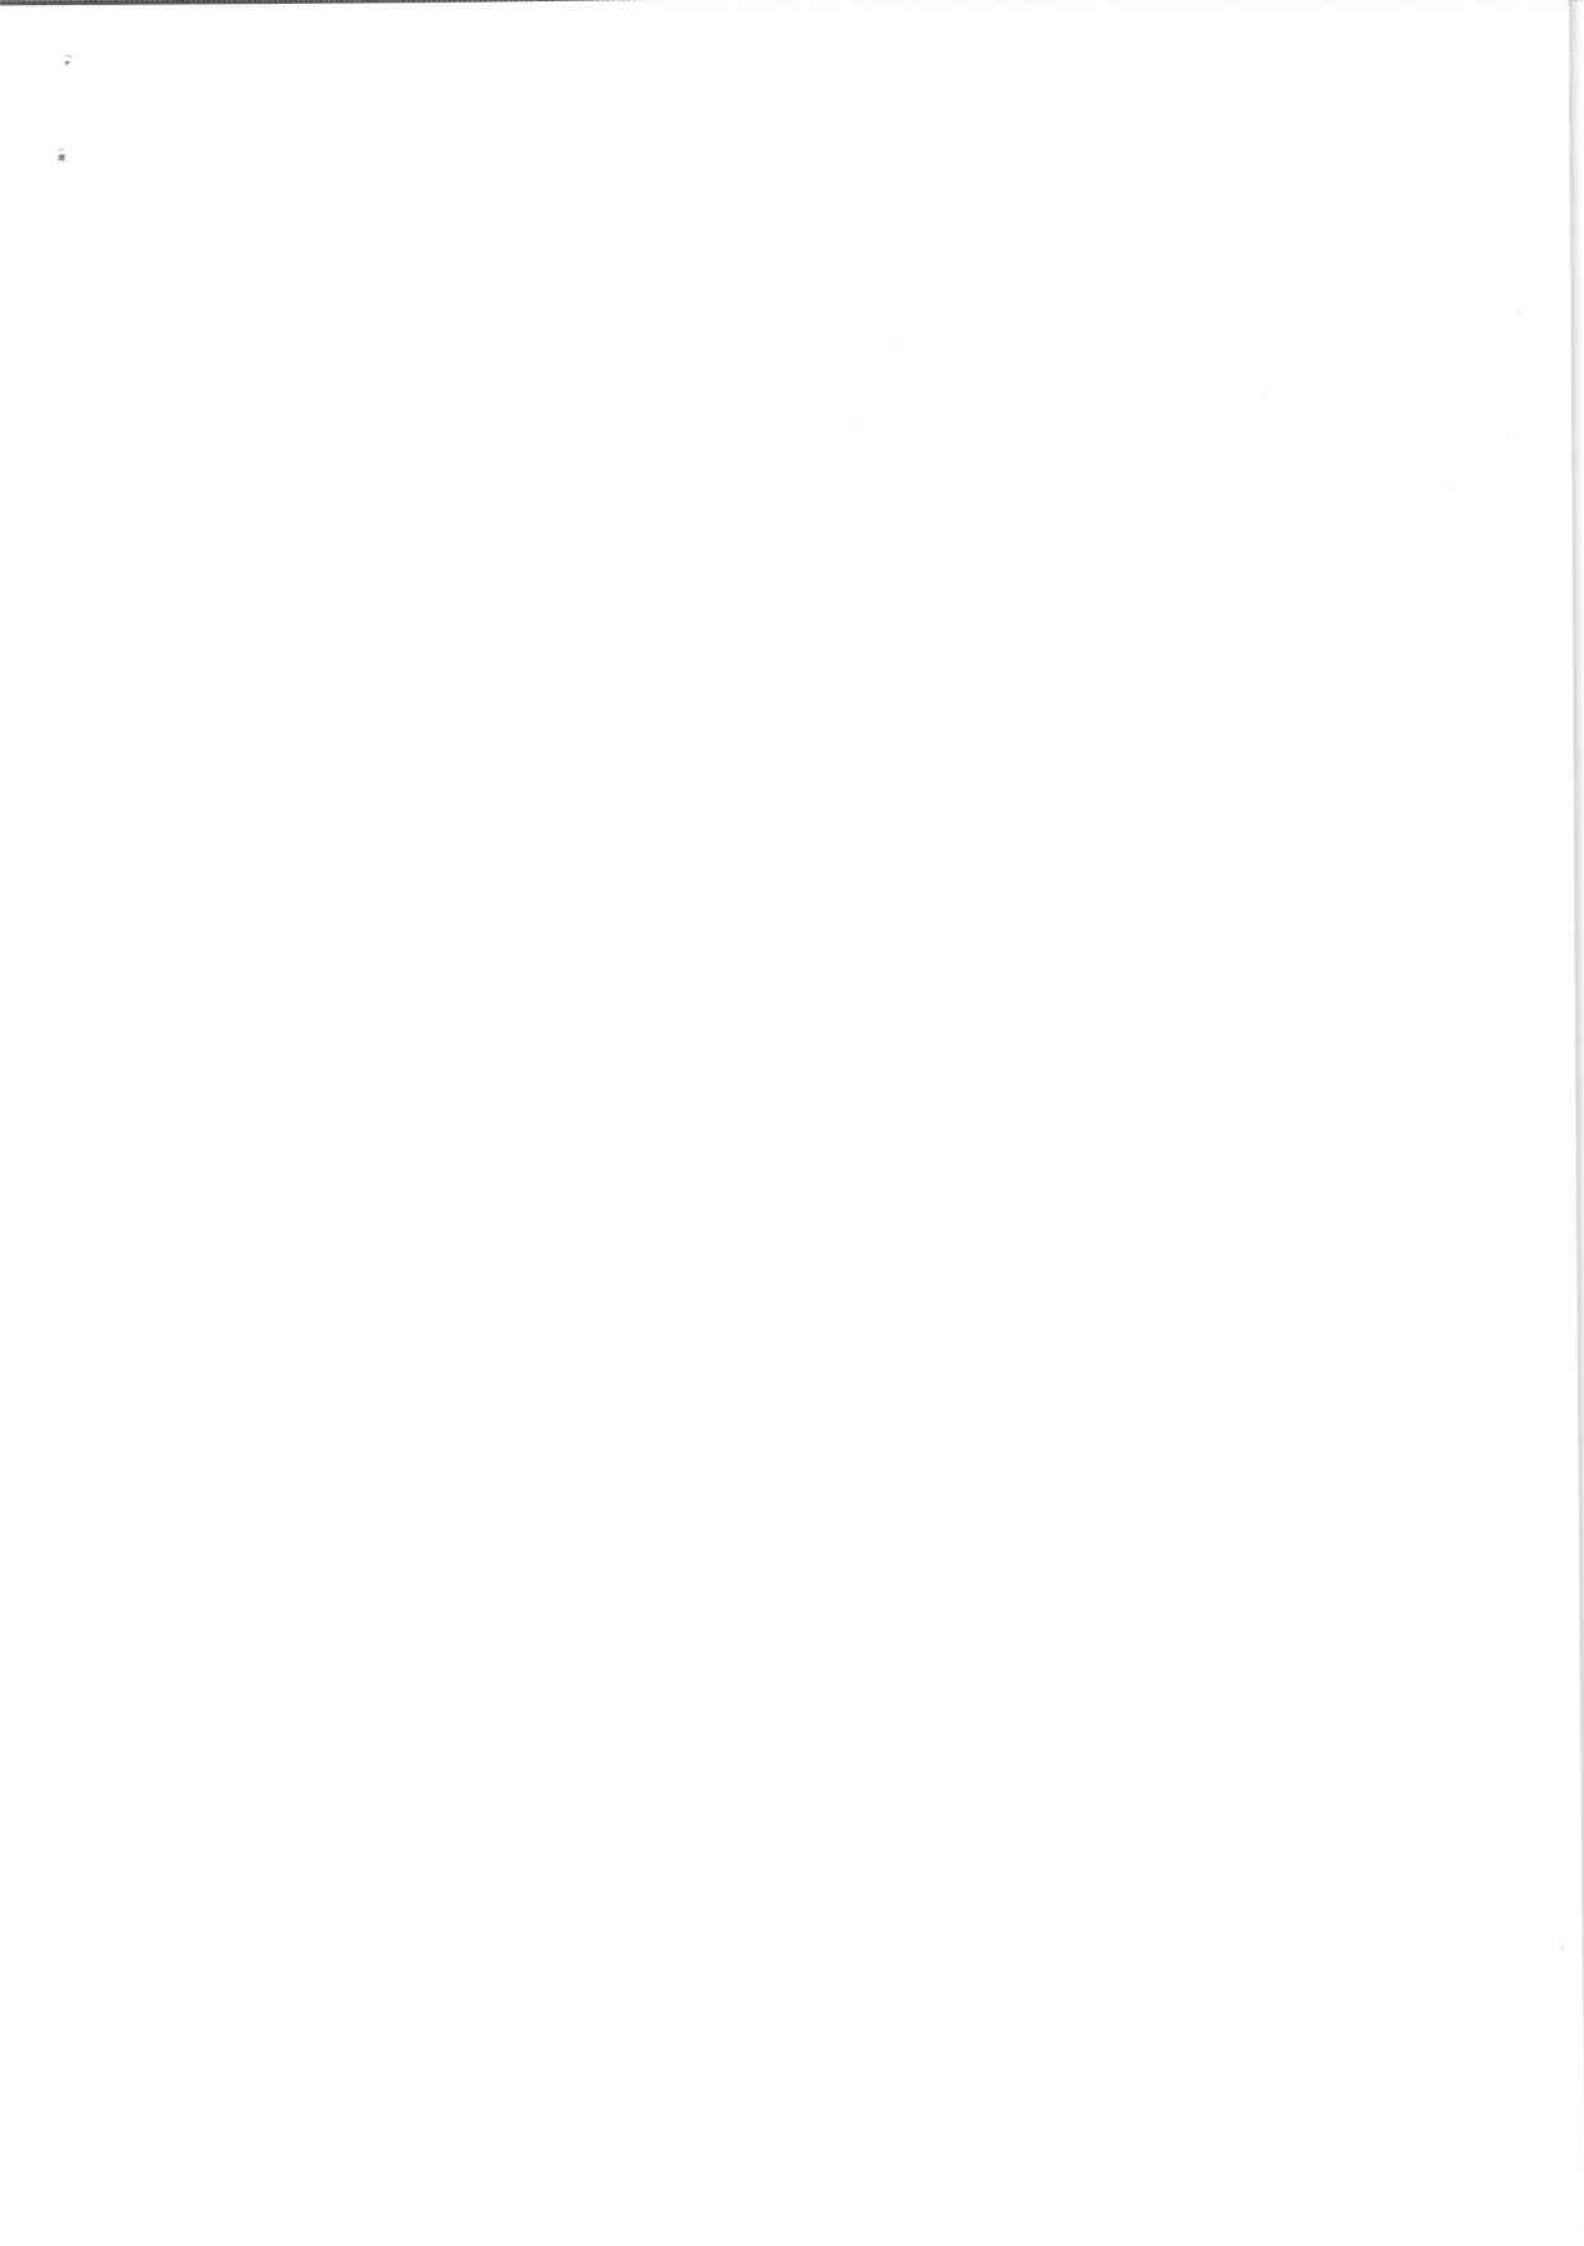

TOTAL				<p>de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	
-------	--	--	--	--	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Boris Graneci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL
 Adresa: Str. Miron Costin 17/7, of 71
 Tel/Fax: +373 22 52-30-90
 Email: medglobalfarm@mail.ru
 Site: www.medglobalfarm.com

